CATALOGO ANALISI IN FARMACIA



Finecare FS-114



Pointcare M4

MINIAS

Indice

Lipid Panel Meter **1**

Limpid Pro **3**

Pointcare **5**

Compass-2000 ..... **7**

Renal Function Meter **9**

Finecare **11**

V Chek **16**

BioHermes **21**

Compass-3000 ..... **23**

MicroPoint **26**

Emocromo **28**

Emocromo POC **29**

Analisi delle Urine **31**

Intolleranze Alimentari **33**

Extrapharm **35**

HS7 ..... **36**

Termometri monouso Medical Indicators **37**

Servizi Post-Vendita **39**

Lipid Panel Meter

Sistema per il dosaggio di Profilo Lipidico, Colesterolo e Trigliceridi



Range di Misura:

- Colesterolo: 100-500 mg/dL
- Trigliceridi: 45-650 mg/dL
- HDL: 15-100 mg/dL

Memoria: 500 risultati

Dimensioni: 135x66x19 mm

Peso: 120g

Batteria ricaricabile

Tipo di campione: sangue capillare

Volume di campione:

- 35 µL per Profilo Lipidico
- 10 µL per Colesterolo Totale e Trigliceridi

Metodo di prelievo: capillare











Kit disponibili:

- Profilo Lipidico (LPS-101), 10 strisce
- Colesterolo Totale (TCS-101), 25 strisce
- Trigliceridi (TGS-101), 25 strisce

Conservazione a temperatura ambiente

Dotati di chip per la calibrazione

Scadenza: 18 mesi dalla produzione

Lipid Panel Meter

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Lipid Panel Meter Strumento di chimica secca con tecnologia a biosensori per l'analisi di profilo lipidico, colesterolo e trigliceridi.	LPM-101	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Blood Lipid Test Strip Striscia di reazione per la determinazione del pannello lipidico nel sangue capillare (Colesterolo totale, Trigliceridi, HDL e LDL). Volume: 35 uL	LPS-101-10	10 Test
Total Cholesterol Test Strip Striscia di reazione per la determinazione del Colesterolo Totale. Volume: 10 uL	TCS-101	25 Test
Triglycerides Test Strip Striscia di reazione per la determinazione dei Trigliceridi. Volume: 10 uL	TGS-101	25 Test

Controlli

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
HDL and Triglycerides Control Solution	LPS - A/B/C	1x2mL
Total Cholesterol Control Solution	TCS - A/B/C	1x2mL

Limpid Pro Multi-Monitoring System

Sistema per il dosaggio di Glucosio nel sangue, Emoglobina Totale, Chetoni e Acido Urico



Range di Misura:

- Glucosio nel sangue: 10,8-600 mg/dL
- Emoglobina Totale: 5,0-26,0 g/dL
- Chetoni: 0,1-8,0 mmol/L
- Acido Urico: 3,0-20,0 mg/dL

Memoria: 900 risultati

Dimensioni: 89,5x52,1x17,7 mm

Peso: 55g


Tipo di campione: sangue capillare

Volume di campione:

- 0,5 µL per Glucosio ed Emoglobina Totale
- 0,8 µL per Chetoni
- 1,6 µL per Acido Urico

Metodo di prelievo: capillare

Risultato in 5 secondi

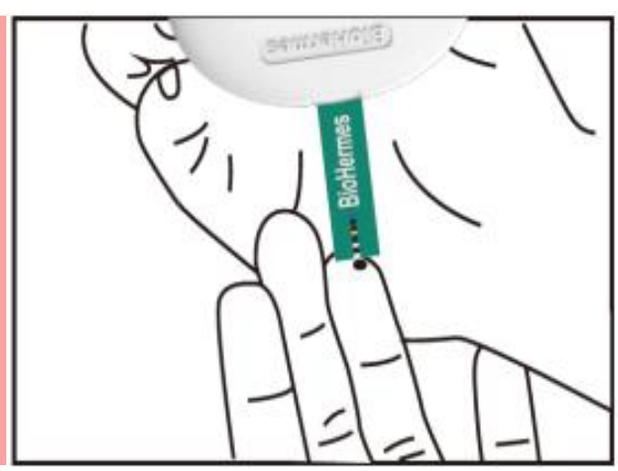



Kit disponibili:

- Glucosio (GLU-S52), 2 x 25 test
- Acido Urico (GUK-S022), 2 x 25 test
- Chetoni (GUK-S032), 2 x 25 test
- Glucosio + Emoglobina Totale (GUK-S042), 2 x 25 test

Conservazione a temperatura ambiente

Limpid Pro

Strumenti


Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Limpid Pro Multi-Monitoring System Misuratore di glucosio nel sangue, chetoni, acido urico ed emoglobina da sangue capillare.	GUK-M31	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Blood Glucose Test Strip Strisce reattive per la determinazione di glucosio da sangue capillare.	GLU-S52	2 x 25 test
Blood Glucose/Hemoglobin Test Strip Strisce reattive per la determinazione di glucosio ed emoglobina totale da sangue capillare.	GUK-S042	2 x 25 test
Blood Ketone Test Strip Strisce reattive per la determinazione di acido β-idrossibutirrico, che rappresenta il 78% dei corpi chetonici totali nel sangue, da sangue capillare.	GUK-S032	2 x 25 test
Uric Acid Test Strip Strisce reattive per la determinazione di acido urico da sangue capillare.	GUK-S022	2 x 25 test

Controlli

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Multi Control Solution Soluzione di controllo qualità a 2 livelli per glucosio, chetoni e acido urico.	GUK-C011	2 X 2 mL

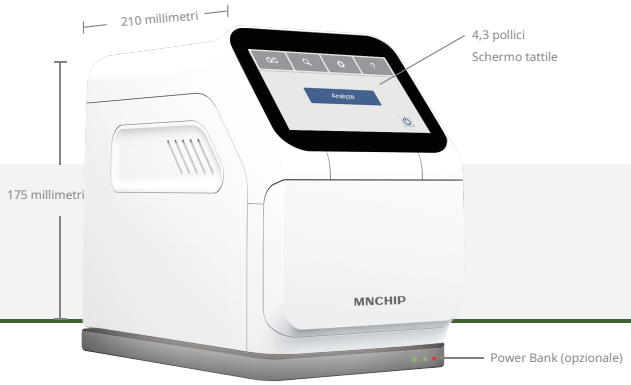

Sorgente di luce Xeno

Rotore per reagenti microfluidici

Clinical Chemistry+ - Pointcare® M4 Blood Chemistry Analyzer


FACILE DA USARE

Sistema completamente automatico: non sono richieste competenze operative particolari


- Schermo touch capacitivo da 4,3 pollici
- 100 µL di sangue intero, siero o plasma
- Informazioni di calibrazione prefabbricate con codice a barre.
- Compatibile con LIS, non è necessario inserire manualmente le informazioni del paziente.
- I risultati possono essere stampati tramite una stampante termica (facoltativa), una stampante da ufficio o tramite la piattaforma di gestione dei dati (MDMP).
- Possibilità di stampare report con il logo del tuo studio installando la piattaforma di gestione dei dati medici MNCHIP.

RISULTATI RAPIDI

Dal campione ai risultati completi in 3 semplici passaggi in pochi minuti

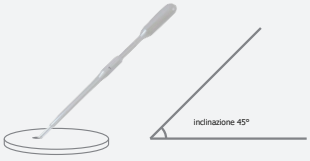

1. Aggiungi campione



2. Inserire il disco



3. Leggi i risultati

MISURAZIONI PRECISE

La tecnologia avanzata garantisce risultati precisi

- I dischi microfluidici con sfere reagenti preinstallate garantiscono un'analisi accurata dei campioni di sangue e dei reagenti.
- L'ottica di misurazione stabile comprende una lampada stroboscopica allo xeno, un sistema di selezione della lunghezza d'onda e un rilevatore a più lunghezze d'onda.
- Un software integrato di controllo qualità monitora l'intero processo in tempo reale (garantendo un'analisi coerente dei campioni di sangue, dei reagenti, dei dischi microfluidici e dell'analizzatore chimico).

Specifiche

Tipo di campione	Sangue intero, plasma, siero
Dimensione del campione	100µL
Tempo di risultati	Circa 7-12 minuti
Interfaccia utente	Schermo touch da 4,3 pollici
Temperatura di reazione	37°C±0,2°C
Requisiti di potenza	120VA
Dimensioni	210 (L) × 125 (P) × 175 (A) mm
Peso netto	Circa 2,5 kg

Parametri	Fino a 19 parametri in un test, 33 parametri configurati in 10 profili
Disco reagente	Monouso, preconfezionato con reagente liofilizzato autonomo
Calibrazione	Autocalibrazione automatica tramite scansione del codice QR sulla busta di alluminio
Controllo di qualità	Sistema di controllo qualità in tempo reale (RQC) integrato
Interfacce di connessione	Interfaccia WLAN, USB, Ethernet, compatibile con LIS
Modalità di stampa	Stampante termica esterna opzionale, stampante da ufficio (opzionale), MDMP, LIS
Capacità dei dati	50.000 risultati di test e dati di controllo qualità
Ambiente operativo	Temperatura 10-30°C, umidità 40-85%

Pointcare

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Pointcare M4 Strumento di chimica a rotori. Ampio display touch screen. Ampi pannelli con 100uL di campione di sangue intero, siero o plasma richiesti. Risultati entro 12 minuti.	110061	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Electrolyte Panel Lyophilized Kit Parametri assegnati: K+, Na+, Cl-, Ca2+, P, Mg2+, CO2. Volume di campione: 100uL	213043	10 Rotori
General Chemistry IV Lyophilized Kit Parametri analizzati: TP, ALB, GLO, A/G, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL, UA, CRE, UREA, GLU, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C. Volume di campione: 100uL	213077	10 Rotori
Glucose and Lipid Panel Lyophilized Kit Parametri analizzati: GLU, GSP, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C. Volume di campione: 100uL	213082	10 Rotori
Liver Function Panel Lyophilized Kit Parametri analizzati: TP, Alb, GLO, A/G, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL. Volume di campione: 100uL	213078	10 Rotori
Renal Function Lyophilized Kit - su richiesta Parametri assegnati: ALB, UA, CRE, UREA, Ca2+, P, CO2. Volume di campione: 100uL	213079	10 Rotori

Compass 2000™

Analizzatore di chimica secca



Analizzatore Point of Care per sangue capillare

- ▷ Profilo Lipidico, Glicemia, Funzionalità renale, Funzionalità epatica, screening metabolico, etc.
- ▷ Tipo di campione: sangue capillare, sangue venoso, siero, plasma
- ▷ Volume di campione: 45 µL
- ▷ Tempo di analisi: < 3 minuti

Compass-2000

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Dry Biochemical Analyzer Analizzatore di test biochimici in chimica secca.	COMPASS2000-1	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Kidney Function: UREA, CRE, UA Striscia di reazione per la determinazione della funzionalità renale (Urea, Creatinina e Acido Urico) da prelievo di sangue capillare.	Diacard-4	10 Test
Lipid + Glucose: TC, TG, HDL-C, LDL-C, GLU Striscia di reazione per la determinazione del profilo lipidico e glicemia (Colesterolo Totale, Trigliceridi, Colesterolo HDL, Colesterolo LDL e Glucosio) da prelievo di sangue capillare.	Diacard-1	10 Test
Liver Function: ALB, ALT, AST Striscia di reazione per la determinazione della funzionalità epatica (Albumina, ALT e AST) da prelievo di sangue capillare.	Diacard-6	10 Test
Screening for Blood Donors: HB, ALT Striscia di reazione per la determinazione di Emoglobina Totale e ALT da prelievo di sangue capillare.	Diacard-8	10 Test
Screening for Metabolic Diseases: TC, UA, GLU Striscia di reazione per lo screening di malattie metaboliche (Colesterolo Totale, Acido Urico e Glucosio) da prelievo di sangue capillare.	Diacard-5	10 Test

Renal Function Meter

Sistema per il dosaggio della Creatinina e del profilo renale da sangue capillare

Range di misura:
- Creatinina: 0.5 - 15 mg/dL
- Acido Urico: 1.5 - 20 mg/dL
- Urea: 5.4 - 240 mg/dL

Tipo di campione: sangue capillare
Volume di campione: 10/35 µL
Conservazione: temperatura ambiente
Memoria: 500 risultati
Batteria ricaricabile
Dimensioni: 135x66x19 mm
Peso: 90 g



Renal Function Meter

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Renal Function Meter Sistema di analisi per Acido Urico, Creatinina e Urea.	RFM-101	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Creatinine Test Strips Strisce reattive per Renal Function Meter per il dosaggio della Creatinina.	CRS-102	25 Test
Renal Function 3 in 1 Test Strips Strisce reattive per Renal Function Meter per il dosaggio di Acido Urico, Creatinina e Urea.	RFS-101	25 Test

Controlli

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Renal Function Control Solution	RFC-02	1x2mL

Sistema Finecare™

Finecare™ Meter Plus (FS-114, FS-113)

Sistema di misura ad immunofluorescenza per l'esecuzione di dosaggi quantitativi da prelievo capillare.



FS-114

Esecuzione del test in tre semplici passaggi

1. Raccolta del sangue capillare
2. Miscelazione del sangue capillare con il reagente
3. Aggiunta della miscela sulla card reattiva



FS-113

Caratteristiche Tecniche

- Sorgente di eccitazione a LED
- Interfaccia Touchscreen
- Stampante integrata
- Dimensioni: 270x238x146 mm
- Peso: 2.8 Kg
- Batteria ricaricabile (FS-114)



Test Disponibili:

- Infiammazione (CRP)
- Diabete (HbA1c, Microalbumina)
- Gravidanza (β-HCG)
- Tiroide (TSH, FT3, FT4, T3, T4)
- Prostata (PSA, PSA libero)
- COVID (Anticorpi 2019-nCoV)
- Sangue Occulto nelle Feci (FOB)
- H.pylori Antigene
- Infezioni respiratorie (RSV, Strepto A)
- Fattore reumatoide
- Vitamina D

Specifiche

- Kit da 25 test per kit
- Conservazione a temperatura ambiente
- Non necessita calibrazione
- Scadenza 2 anni dalla produzione

Finecare

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Finecare FIA Meter II Plus SE Sistema di analisi immunocromatografico a fluorescenza con controllo interno della temperatura, utile per analisi POC per la diagnosi di condizioni quali infezioni, diabete, malattie cardiovascolari, disfunzioni ormonali, lesioni renali e tumori. Schermo LCD touch screen, batteria ricaricabile integrata che permette di eseguire fino a 10 test in modalità standard e stampante integrata. Il set comprende: Manuale operativo, cavo corrente e cavo connessione.	FS-114	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Finecare beta-hCG Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio delle beta-hCG nel sangue intero, nel siero e nel plasma. È usato per la diagnosi precoce della gravidanza. Volume del campione: 20 µl Range di misurazione: 2 – 200000 mIU/mL	W225	25 Test
Finecare CRP Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio in vitro della proteina C-reattiva (CRP) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 5/8,5 µl Range di misurazione: 0.5 – 200 mg/L (hsCRP + CRP)	W201	25 Test
Finecare Ferritina Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della Ferritina nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 75 ul Range di misurazione: 5 – 1000 ng/mL	W269	25 Test
Finecare FOB Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio del sangue occulto nelle feci (FOB). È usato per fornire un aiuto nella diagnosi del cancro al colon. Range di misurazione: 25 – 1000 ng/mL	W279P0001	25 Test
Finecare H.pylori Ag Test rapido qualitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio di Helicobacter pylori Antigene mediante campione fecale. Risultati espressi come indice su cut-off.	W270P0001	25 Test
Finecare HbA1c Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio in vitro dell'emoglobina glicata (HbA1c) nel sangue umano. È usato per il monitoraggio delle patologie diabetiche. Volume del campione: 10 µl Range di misurazione: 4 – 14.5 %	W207	25 Test
Finecare Microalbumina Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio in vitro della microalbumina (MAU) nelle urine umane. È usato per la diagnosi di danno renale. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 5 – 300 mg/L	W206	25 Test

Finecare

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Finecare PSA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio in vitro dell'antigene prostatico specifico (PSA) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 2 – 100 ng/mL	W209	25 Test
Finecare RSV Ag Test Test rapido qualitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio dell'antigene del virus sinciziale respiratorio mediante tampone nasofaringeo. Risultati espressi come indice su cut-off.	WW10P0002	25 Test
Finecare Strep A Ag Test Test rapido qualitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio dell'antigene dello Streptococco di gruppo A mediante tampone orofaringeo. Risultati espressi come indice su cut-off.	W11P0001	25 Test
Finecare TSH Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio dell'ormone stimolante la tiroide (TSH) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. È usato come ausilio nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 0.1 – 100 mIU/L	W220	25 Test
Finecare Vitamina D Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della Vitamina D nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 15 µl Range di misurazione: 5-100 ng/mL	W241P0009	25 Test

Controlli

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Finecare Beta-HCG Control	W819	Liofili, 3 liv x 0.5 ml
Finecare CRP Control	W806	Liofili, 3 liv x 0.5 ml
Finecare Ferritin Control	W898P0001	Liofili, 2 liv x 0,5 ml
Finecare fT3 Control	W893P0001	Liofili, 3 liv x 0,5 ml
Finecare fT4 Control	W894P0001	Liofili, 3 liv x 0,5 ml
Finecare HbA1c Control	W873	Liofili, 2 liv x 0.5 ml
Finecare MAU Control	W813	Liofili, 3 liv x 0.5 ml
Finecare PSA Control	W814	Liofili, 3 liv x 0.5 ml
Finecare T3/T4/TSH Multi-Control	W828	Liofili, 3 liv x 0,5 ml
Finecare Vitamin D Control	W867-Z0P1-AG	Liofili, 2 liv x 0,5 ml

Finecare

Test Rapidi

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Strepto A Test rapido per il rilevamento qualitativo dell'antigene streptococcico del gruppo A da campioni di tampone faringeo.	W39-C W039P0001	25 Test 1 Test

Finecare

Reagenti specialistici, fornitura su richiesta

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Finecare fPSA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio in vitro della frazione libera dell'antigene prostatico specifico (fPSA) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 0.2 – 30 ng/mL	W230	25 Test
Finecare FT3 Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della triiodotironina libera (FT3) nel siero umano, nel plasma e nel sangue intero. È usato per fornire un aiuto nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 75 ml Range di misurazione: 0.40 – 50 pmol/L	W200	25 Test
Finecare FT4 Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della tiroxina libera (FT4) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. È usato come ausilio nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 75 ml Range di misurazione: 1 – 100 pmol/L	W259	25 Test
Finecare RF Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio del Fattore Reumatoide (RF) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 10 uL Range di misurazione: 10-650 IU/mL	W262P0001	25 Test
Finecare T3 Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della triiodotironina (T3 totale) nel siero umano, nel plasma e nel sangue intero. È usato per fornire un aiuto nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 0.61 – 9.22 nmol/L	W231	25 Test
Finecare T4 Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della tiroxina (T4 totale) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. È usato come ausilio nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 12.87 – 300 nmol/L	W232	25 Test

Analizzatori in Fluorescenza
V-Chek™



CHF200

CHF300



Tecnologia ad immunofluorescenza

Gli analizzatori VChek sono sistemi di misura per analisi in immunofluorescenza. Disponibili in versione da banco o portatile, sfruttano la tecnologia Time-Resolved Immunoassay.

- Linea di reagenti ampia con confezioni da 25 test
- Conservazione a temperatura ambiente

Famiglia	Test	Tempo di reazione	Range di misura
Diabete	Emoglobina Glicata (HbA1c)	5 minuti	3 - 14%
Infiammazione	Proteina C Reattiva (CRP e hsCRP)	3 minuti	0.5 - 200 mg/L
	Procalcitonina (PCT)	15 minuti	0.1 - 100 mg/L
Coagulazione	D-Dimero	5 minuti	0.1 - 10 mg/L
Fertilità	β-HCG	15 minuti	5 - 200000 mIU/mL
	LH	15 minuti	1 - 100 mIU/mL
	FSH	15 minuti	1 - 100 mIU/mL
	Prolattina	15 minuti	1 - 20 ng/mL
Tiroide	TSH	15 minuti	0.1 - 100 ng/mL
	T3	15 minuti	0.61 - 9.22 nmol/L
	T4	15 minuti	12.87 - 300 nmol/L
	fT3	15 minuti	0.60 - 45.00 pmol/L
	fT4	15 minuti	1.0 - 100.0 pmol/L
Altro	Ferritina	10 minuti	5 - 500 ng/mL
	25OH Vitamina D	10 minuti	5 - 100 ng/mL

V Chek

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
ImmunoFluorescence Analyzer CHF200 - ad esaurimento Lettore immunocromatografico a fluorescenza con controllo interno della temperatura. Schermo LCD touch screen e stampante integrata. Il set comprende: Manuale operativo, cavo corrente e cavo connessione.	CHF200001	1 pz
ImmunoFluorescence Analyzer CHF300 Lettore immunocromatografico a fluorescenza portatile con controllo interno della temperatura. Schermo LCD touch screen e stampante integrata. Il set comprende: Manuale operativo, cavo corrente e cavo connessione.	CHF300	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
2019-nCoV Ag Quantitative Test Kit Test rapido quantitativo e qualitativo immunologico a fluorescenza per la ricerca dell'antigene del virus SARS-CoV-2 in tampone nasale o naso-faringeo. Risultato espresso in termini quantitativi di antigene (ng/mL) e qualitativi (negativo, dubbio, positivo).	0625C4X025	25 Test
CRP FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio in vitro della proteina C-reattiva (CRP e hsCRP) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 5 µl Range di misurazione: 0.5 – 200 mg/L (hsCRP + CRP)	5084C4X025	25 Test
HBA1C FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio in vitro dell'emoglobina glicata (HbA1c) nel sangue intero umano. È usato per il monitoraggio delle patologie diabetiche. Volume del campione: 5 µl Range di misurazione: 2 – 14 %	5257C4X025	25 Test
TSH FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio dell'ormone stimolante la tiroide (TSH) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. È usato come ausilio nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 0.1 – 100 mIU/L	5284C4X025	25 Test
Vitamin D FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della Vitamina D (VD) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 10 µl Range di misurazione: 5 – 100 ng/mL	5318C4X024	24 Test
βhCG FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio in vitro della subunità beta della gonadotropina corionica (βHCG) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 10 µl Range di misurazione: 5 – 200000 mIU/mL	5014C4X025	25 Test

V Chek

Controlli

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
CRP Control	A16QL0B	1 pz
D-Dimer Control	A15QL0B	1 pz
HbA1c Control	A18QL0B	1 pz
PCT Control	A12QL0B	1 pz
T3/T4/TSH Control	A19QL0B	1 pz
βhCG Control	A17QL0B	1 pz

Test Rapidi

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
2019-nCoV Ag Rapid Test Kit Test rapido immunocromatografico per la ricerca qualitativa dell'antigene del virus SARS-CoV-2 da tampone nasale o naso-faringeo. Tempo di lettura 15 minuti.	0555C2X025	25 Test

V Chek

Reagenti specialistici, fornitura su richiesta

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
D Dimero Fia Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio del D-Dimero nel sangue intero umano o nel plasma. Volume del campione: 10 µl Range di misurazione: 0,1 – 10 mg/L	5274C4X025	25 Test
Ferritina FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della Ferritina nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 5 – 500 ng/mL	5414C4X025	25 Test
FSH FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio dell'FSH (Ormone Follicolo Stimolante) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 1 – 100 Miu/Ml	5404C4X025	25 Test
FT3 FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della triiodotironina libera (FT3) nel siero umano, nel plasma e nel sangue intero. È usato per fornire un aiuto nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 0.40 – 50 pmol/L	5324C4X025	25 Test
FT4 FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della tiroxina libera (FT4) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. È usato come ausilio nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 150 µl Range di misurazione: 1 - 100 pmol/L	5334C4X025	25 Test
LH FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio dell'LH (Ormone Luteinizzante) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 1 – 100 mIU/mL	5024C4X025	25 Test
PCT FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della Procalcitonina nel siero umano, nel plasma e nel sangue intero. È usato per fornire un aiuto nella diagnosi di infezioni sistemiche virali o batteriche. Volume del campione: 50 µl Range di misurazione: 0. 1 – 100 ng/Ml	5074C4X025	25 Test
PRL FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della Prolattina nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 1 – 200 mIU/mL	5054C4X025	25 Test
T3 FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della triiodotironina (T3 totale) nel siero umano, nel plasma e nel sangue intero. È usato per fornire un aiuto nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 75 µl Range di misurazione: 0.61 – 9.22 nmol/L	5304C4X025	25 Test

V Chek

Reagenti specialistici, fornitura su richiesta

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
T4 FIA Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della tiroxina (T4 totale) nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. È usato come ausilio nella diagnosi funzionale della tiroide. Volume del campione: 150 µl Range di misurazione: 12.5 – 300 nmol/L	5294C4X025	25 Test

A1C EZ 2.0

Sistema Di Misurazione dell'Emoglobina Glicata per Autoanalisi



Analizzatore portatile per il dosaggo della HbA1c

Risultati accurati

Misurazioni facili e veloci

Conservazione a temperatura ambiente

Un sistema semplice ed affidabile per il monitoraggio delle patologie diabetiche

Caratteristiche	Specifiche Tecniche
Principio di analisi	Cromatografia in affinità al boronato
Parametro analizzato	Emoglobina glicosilata (HbA1c)
Range di Misurazione	4 % - 14 %
Precisione	CV < 3% (HbA1c: 4.0% - 6.5%)
Tipo di Campione	Sangue capillare o venoso (anticoagulante: EDTA)
Volume di Campione	Circa 3 µl
Tempo di Analisi	Circa 5 minuti
Unità di Misura	Preimpostata: NGSP % ; IFCC mmol/mol
Guida Vocale	Durante tutta l'analisi
Memoria	1000 risultati
Interfacciamento	Porta mini USB per connessione a sistema HIS/LIS o a stampante termica
Bluetooth	Opzionale
Alimentazione	4 pile AAA
Dimensioni dello Schermo	47 mm x 32 mm
Peso (escluse le pile)	112 g
Condizioni di lavoro	Temperatura: 10°C – 40°C; Umidità: 30% - 70%
Condizioni di conservazione	Temperatura: 10°C – 50°C; Umidità: < 80%
Dimensioni	61,5 mm x 122,9 mm x 24,5 mm

BioHermes

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
AC1 EZ 2.0 Analizzatore per la misurazione dell'Emoglobina Glicosilata nel sangue intero. Il set comprende: garanzia, manuale operativo e manuale di manutenzione e pulizia.	A1C-M21	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
A1C EZ 2.0 Strisce di analisi Strisce di test per la determinazione quantitativa dell'Emoglobina Glicosilata nel sangue intero. Range di misura: 4% - 14% Volume campione: 3 µl Tempo di analisi: 5 minuti	A1C-S22_12T A1C-S22	12 Test 25 Test

Vitamina D - Compass 3000

Test quantitativo da sangue capillare



Analizzatore Point of Care di Vitamina D per sangue capillare

- Risultati quantitativi
- Tipo di campione: sangue capillare, sangue venoso, siero, plasma
- Volume di campione: 20 µL
- Tempo di analisi: < 15 minuti
- Altri test disponibili: **Ferritina** - **Proteina C Reattiva**

Compass-3000

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Fluorescence Immunoassay Analyzer - ad esaurimento Lettore immunocromatografico a fluorescenza con controllo interno della temperatura. Schermo LCD touch screen e stampante integrata. Il set comprende: Manuale operativo, cavo corrente e cavo connessione.	COMPASS3000-1	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
CRP Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della Proteina C Reattiva nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 10 µl Range di misurazione: 0.5 – 150 mg/L	INFCRP-402F-25	25 Test
VIT D 25-OH-Vitamin D Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della Vitamina D nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 20 µl Range di misurazione: 5 – 120 ng/mL	OVD-402F-25	25 Test

Compass-3000

Reagenti specialistici, fornitura su richiesta

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Ferritina Test rapido quantitativo immunologico a fluorescenza per il dosaggio della Ferritina nel sangue intero umano, nel siero o nel plasma. Volume del campione: 20 µl Range di misurazione: 6 – 1000 ng/mL	OFER-402F-25	25 Test

qLabs® ElectroMeter
Sistemi per Coagulazione

qLabs® Electrometer (Autoanalisi)
Sistema palmare per il monitoraggio dei parametri di coagulazione PT e INR.
Il sistema è certificato per autoanalisi e permette il dosaggio del tempo di protrombina (PT) e il calcolo del rapporto internazionale normalizzato (INR) entro due minuti.
Per il funzionamento è sufficiente una goccia di sangue capillare applicata direttamente sulla striscia reattiva e non richiede calibrazioni o manutenzioni.

- Certificato CE(0123) Nr.: V1 077717 0011 Rev. 01



qLabs® Electrometer Plus
Sistema palmare ad uso professioinale per il monitoraggio dei parametri di coagulazione PT/INR e aPTT.
Il sismtea permette il dosaggio del tempo di protrombina (PT), il calcolo del rapporto internazionale normalizzato (INR) e il tempo di trombina parziale attivata (aPTT).
Per il dosaggio è sufficiente una goccia di sangue capillare o venoso fresco (almeno 10 microlitri), senza anticoagulanti

Strisce reattive per sistemi qLabs®
I reagenti per i sistemi qLabs® sono strisce reattive da inserire nel lettore e su cui applicare il sangue campione.

- Le strisce PT/INR possono essere utilizzate con lettori Q3 e Q3-Plus.
- Le strisce PT/INR/APTT solo con lettori Q3-Plus.

I reagenti sono stabili 18 mesi dalla fabbricazione e sono conservati a temperatura ambiente.



eStation II
Base accessorio per lettori Q3 e Q3 Plus per la ricarica ed altre funzioni aggiuntive.
La base di ricarica eStation II implementa le seguenti funzioni:

- Ricarica di **qLabs® Electrometer Plus**
- Stampa dei risultati
- Connessione con sistema qLabs via bluetooth
- Interfacciamento a sistema LIS host esterno

MicroPoint

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
eStation II Base di ricarica per qLabs ElectroMeter Q-3 e Q-3 Pro che offre funzioni aggiuntive come la ricarica, la stampa e la trasmissione dei dati.	MBI92	1 pz
qLabs® ElectroMeter Sistema portatile per autoanalisi per la misurazione del tempo di protrombina in campioni di sangue fresco capillare. Da utilizzare con strisce reattive qLabs PT-INR.	Q-3	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
qLabs® PT-INR Test Strips Strisce reattive per qLabs® PT-INR per la misurazione del tempo di protrombina (PT) e il calcolo del Rapporto Internazional Normalizzato (INR).	QS-1-12	12 Test

Emocromo

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Analizzatore automatico di ematologia 5 Diff POCT Analizzatore automatico Point of Care di ematologia per l'esecuzione dell'esame emocromocitometrico completo a 24 parametri con formula leucocitaria a 5 popolazioni. Volume del campione: 30 uL Tempo di esecuzione: 7 minuti	iMC-Ge52e	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
CBC 5 Diff emocromo kit Kit reagenti per analizzatore automatico di ematologia 5 Diff POCT iMC-Ge52e. Cartucce confezionate singolarmente.	JY-05	50 pz



Sangue Capillare

5 Popolazioni Wbc

Kit di analisi Singoli

Senza Manutenzione

White Blood Cell & Hemoglobin Analyzer

Sistema Point of Care per Emocromo



Sistema Point of Care per Formula Leucocitaria, Emoglobina Totale ed Ematocrito da Sangue Capillare

WBC Analyzer: per la quantificazione dei **leucociti totali** e la **formula leucocitaria**:

- ▷ Linfociti, Monociti, Basofili, Eosinofili, Neutrofili
- ▷ Sistema ad alta tecnologia basato sulla digitalizzazione e analisi d'immagine microscopica
- ▷ Volume di campione: 10 µL
- ▷ Tempo di analisi: < 3 minuti

Hemoglobin Analyzer: per la quantificazione dell'**Emoglobina Totale** e dell'**Ematocrito**

- ▷ Principio spettrofotometrico
- ▷ Volume di campione: 10 µL
- ▷ Tempo di analisi: < 30 secondi

Emocromo POC

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
H7 Hemoglobin Analyzer Sistema per il dosaggio dell'Emoglobina Totale ed Ematocrito.	H-7	1 pz
WBC Analyzer Sistema per la conta microscopica automatica dei globuli bianchi con formula a 5 parametri (Linfociti, Monociti, Eosinofili, Neutrofili, Basofili).	WBC-5	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
H7 Microcuvette Cuvette di lettura per H7.	HB-1	25 pz
WBC Microcuvette Kit con colorante e microcuvette di lettura per WBC Analyzer.	C101-100	25 pz

Urine Analyzer

Analizzatore compatto di urine

Parametri Testati

- **Urobilinogeno**
- **Bilirubina**
- **Chetoni**
- **Creatinina**
- **Sangue**
- **Proteine**
- **Microalbumina**
- **Nitriti**
- **Leucociti**
- **Glucosio**
- **Peso Specifico**
- **pH**
- **Acido Ascorbico**
- **Calcio**



Caratteristiche Tecniche

Memoria: 1000 risultati
Batteria ricaricabile
Stampante opzionale
Dimensioni: 111x69x28 mm
Peso: 172 g

Analisi delle Urine

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Urine Analyzer Analizzatore semi-automatico per urine a 14 parametri. Connessione USB e bluetooth. Display LCD, batterie ricaricabili. Parametri analizzati: leucociti, nitriti, robilinogeno, proteine, pH, globuli rossi, peso specifico, acido ascorbico, chetoni, bilirubina, glucosio, microalbumina, creatinina, calcio.	HCU02	1 pz

Reagenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Urine Test Strips Strisce reattive a 14 parametri per Urine Analyzer.	STRIP	50 Test

Food Detective® PROFESSIONAL

Goditi la vita senza i sintomi della sensibilità alimentare.

Chiedi al tuo professionista sanitario di Food Detective oggi stesso.



Informing decisions
Improving health

Intolleranze Alimentari

Prodotti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Food Detective	CNSFD	1 Test
Test semi-quantitativo per la rilevazione della sensibilità a 59 alimenti mediante la ricerca di IgG-4 specifiche nel sangue capillare. Volume di campione: 25 uL	CNSFD5	5 Test

Che cos'è la sensibilità alimentare?

La sensibilità alimentare può derivare da una reazione negativa del corpo a determinati alimenti. Spesso, i cibi che consumiamo regolarmente o quelli che desideriamo maggiormente potrebbero essere quelli che ci causano problemi.

La ricerca ha dimostrato che la sensibilità alimentare può essere collegata agli anticorpi IgG prodotti quando questi alimenti "problematici" vengono consumati. Normalmente, questi anticorpi non causano effetti negativi, ma se il sistema immunitario o digestivo non funziona in modo ottimale, la loro presenza può provocare una vasta gamma di sintomi.

Cosa posso fare?

Parla con il tuo professionista sanitario riguardo alla possibilità di fare un test Food Detective®.

Molte persone notano un miglioramento nei sintomi e nella salute dopo aver cambiato la loro dieta in base ai risultati del test Food Detective. Come per qualsiasi test diagnostico, Food Detective produrrà risultati significativi solo se stai sperimentando sintomi. Alcuni sintomi di sensibilità alimentare potrebbero essere causati da altri problemi di salute, ed è importante consultare il medico per escludere queste altre cause.

Come posso sapere se sono sensibile agli alimenti?

Chiediti se hai alcuni dei seguenti **spiacevoli sintomi cronici:**

- ✓ Gonfiore
- ✓ Costipazione
- ✓ Diarrea
- ✓ Meteorismo
- ✓ Mal di testa
- ✓ Sindrome dell'intestino irritabile
- ✓ Stanchezza
- ✓ Emicrania
- ✓ Nausea
- ✓ Crampi addominali / dolore addominale

Perché dovrei fare un test?

Aiuta a ridurre i sintomi velocemente.

I sintomi possono persistere per diversi giorni o più a lungo, rendendo difficile identificare quali alimenti il tuo corpo fatica a gestire.

Il test Food Detective aiuta a identificare questi "alimenti problematici" rilevando gli anticorpi IgG specifici per gli alimenti nel tuo sangue. Utilizzando questi risultati come guida, tu e il tuo professionista della salute potrete quindi adattare e pianificare la tua nuova dieta.

Che cos'è Food Detective?

Food Detective è un test Point-of-careper gli anticorpi IgG che possono essere associati alla sensibilità alimentare. Fornisce ristùtati rapidi, permettendoti di prendere il controllo della tua salute.

Alimenti testati

Il test Food Detective rileva le reazioni ai seguenti alimenti:

Testa le reazioni specifiche agli IgG per 59 alimenti comuni



Latte (vacca), Uova intere

Pesci d'acqua dolce (salmone, trota), Crostacei (gamberetti, gamberi, granchio, aragosta, cozza), Pesci bianchi (merluzzo, stoccafisso, sogliola), Tonno

Mela, Ribes nero, Mix di agrumi (arancia, limone), Pompelmo, Meloni (cantalupo, anguria), Olive, Fragola

Mais, Grano duro, Glutine, Avena, Riso, Segale, Grano

Aglio, Zenzero

Manzo, Pollo, Agnello, Maiale

Fava di cacao, Funghi, Tè, Lievito

Mandorla, Nocciola del Brasile, Anacardo, Arachidi, Noci

Broccoli, Cavolo, Carota, Sedano, Cetriolo, Porro, Legumi (piselli, lenticchie, fagioli bianchi), Peperoni (rossi, verdi, gialli), Patata, Fagiolo di soia, Pomodoro

Cosa dovrei fare dopo il test?

Insieme al tuo professionista sanitario, potrete creare una dieta che elimini gli alimenti problematici, offrendo alternative salutari e indicazioni su come reintrodurre i cibi.

In genere, una dieta personalizzata verrà seguita per circa 3 mesi per permettere ai sintomi di diminuire e dare al corpo il tempo di recuperare.

Per ulteriori informazioni, visita food-detective.com


Chiedi oggi stesso al tuo professionista sanitario del test Food Detective.

ExtraPharm

Software

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Programma ExtraPharm Software di refertazione per farmacie. Il software si interfaccia con gli strumenti iChroma, Finecare Plus, CHF200, VeriQ, ed altri per la trasmissione automatica dei risultati.	SOFTWARE.1	1 licenza



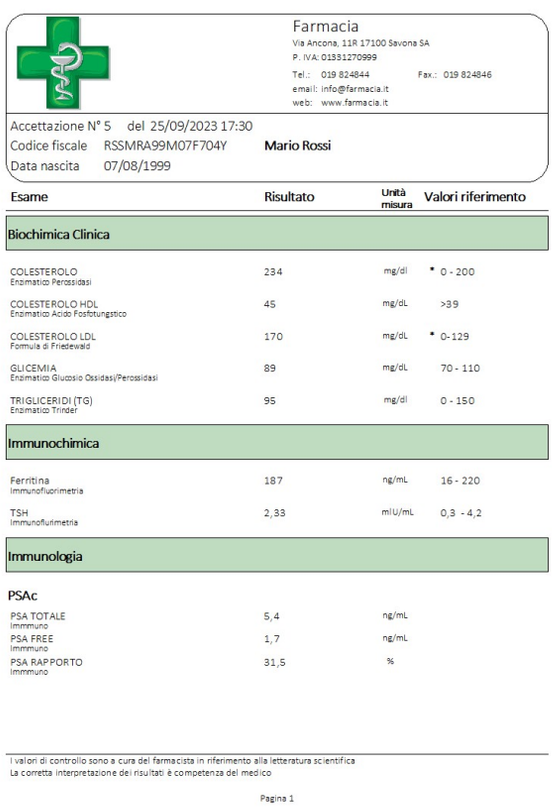

Farmacia
Via Ancona, 11R 17100 Savona SA
P. IVA: 01331270999
Tel.: 019 824844 Fax.: 019 824846
email: info@farmacia.it
web: www.farmacia.it

Accettazione N° 5 del 25/09/2023 17:30
Codice fiscale RSSMRA99M07F704Y Mario Rossi
Data nascita 07/08/1999

Esame	Risultato	Unità misura	Valori riferimento
Biochimica Clinica			
COLESTEROLO Enzimatico Perossidasi	234	mg/dl	* 0 - 200
COLESTEROLO HDL Enzimatico Acido Fosfotungstico	45	mg/dL	>39
COLESTEROLO LDL Formula di Friedewald	170	mg/dL	* 0-129
GLICEMIA Enzimatico Glucosio Ossidasi/Perossidasi	89	mg/dL	70 - 110
TRIGLICERIDI (TG) Enzimatico Trinder	95	mg/dl	0 - 150
Immunochimica			
Ferritina Immunofluorimetria	187	ng/mL	16 - 220
TSH Immunoflurimetria	2,33	mIU/mL	0,3 - 4,2
Immunologia			
PSAc			
PSA TOTALE Immmuno	5,4	ng/mL	
PSA FREE Immmuno	1,7	ng/mL	
PSA RAPPORTO Immmuno	31,5	%	

I valori di controllo sono a cura del farmacista in riferimento alla letteratura scientifica
La corretta interpretazione dei risultati è competenza del medico

Pagina 1

HS7

Strumenti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Stetoscopio	STC-7	1 pz
Tele Medical Monitor Sistema portatile di monitoraggio multi-parametrico delle funzioni vitali come: pressione sanguinea, battito cardiaco, ossimetria, elettrocardiogramma, etc.	HES-7	1 pz

Accessori

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Spirometro	SPM-7	1 pz





NexTemp® Ultra

Termometri

100% IGIENICI • MONOUSO • AFFIDANILITA' CLINICA

SEMPLICI • SICURI • ACCURATI

Per tutta la famiglia

TraxIt®

Termometro ascellare

ADESIVO • A MONITORAGGIO CONTINUO • AFFIDABILITA' CLINICA

Preciso e sicuro da indossare

Monitoraggio continuo,
fino a 48 ore

MEDICAL INDICATORS

Termometri monouso Medical Indicators

Prodotti

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
NexTemp Ultra Termometri monouso: sia per gli operatori sanitari che per le famiglie. Termometro avanzato che offre misurazioni precise e affidabili in 60 secondi. Progettato per garantire la massima precisione e sicurezza, è la scelta ideale sia per l'uso domestico che per quello professionale.	4500-12 8200	12 pz/scatola 100 pz/scatola
TraxIt Termometri monouso a lettura continua per 48 ore. Progettato per il monitoraggio continuo della temperatura per 48 ore, TraxIt offre un rilevamento accurato e delicato della temperatura, riducendo al minimo i disagi. Rilevazione continua della temperatura per 48 ore, senza svegliare il paziente che dorme. Progettato per rimanere in posizione durante il sonno, il bagno e il cambio d'abiti fino a 48 ore.	2313-12 2313	12pz/scatola 100 pz/scatola

Corsi di Formazione

Online

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Corso di Formazione - online Corso di formazione per l'utilizzo degli strumenti e l'esecuzione di test online.	CFO	Online

In sede

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Corso di Formazione - in presenza Corso di formazione per l'utilizzo degli strumenti e l'esecuzione di test in presenza.	CFP	In presenza

Corsi di Aggiornamento

Webinair

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Corsi di Aggiornamento Corsi di Aggiornamento che trattano tematiche relative al mondo Point-of-Care (POCT).	CAW	Webinair

ExtraPharm

Assistenza

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Canone Annuale di Manutenzione e Aggiornamento Assistenza e aggiornamenti per il software ExtraPharm, rinnovo annuale.	AAFR.1	Canone annuale

Teleassistenza

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Interventi ExtraPharm senza Piano Annuale Interventi di teleassistenza sul software ExtraPharm senza aver sottoscritto il piano annuale di teleassistenza.	TA1	In presenza
	TA2	Da remoto

Controllo Strumenti

Controllo Qualità

Prodotto	*Codice*	*Confezione*
Controllo Qualità sui Kit Controllo di qualità con materiale a titolo noto.	CQ1	Singolo strumento
	CQ2	Per ogni strumento aggiuntivo



Hemoglobin Analyzer



Lipid Panel Meter



MINIAS

MINIAS GLOBE DIAGNOSTICS SRL

Via Ancona 11 R – Savona SV – 17100

T +39 019 824 844 | F +39 019 829 418

minias.it | info@minias.it